


Montagemöglichkeiten für Gelöstsauerstoffsonden


Bei Verwendung mit dem DL424/425 Meßumformer ist sowohl eine integrale Montage (Ausführung der Sonde ohne Anschlußkabel) als auch eine abgesetzte Montage (Sonde mit fest angeschlossenenem Kabel) möglich.

Bei der abgesetzten Montage erfolgt der Anschluß des Sondenkabels an den DL424/425 mittels einer Steckverbindung.

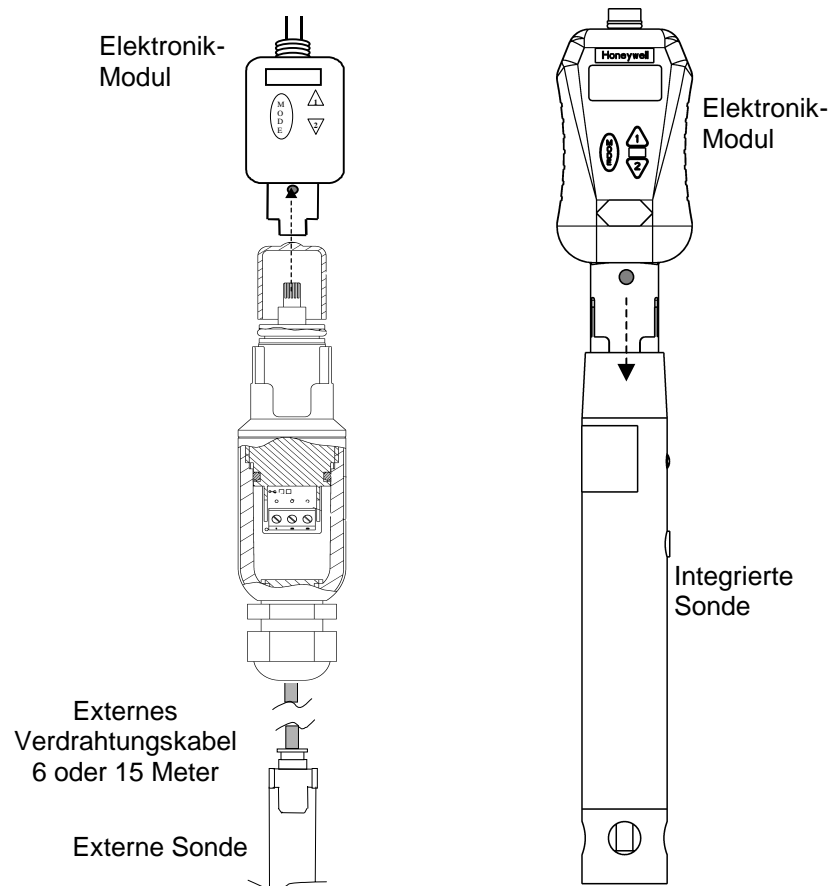


Bei Verwendung mit anderen Honeywell-Meßumformern/Auswertegeräten ist nur die abgesetzte Montage der Sonde möglich. Der elektrische Anschluß des Sondenkabels erfolgt in diesem Fall über Schraubklemmen.

Medium fließt direkt durch die Sonde (nur für reines Wasser geeignet; Flow Through)

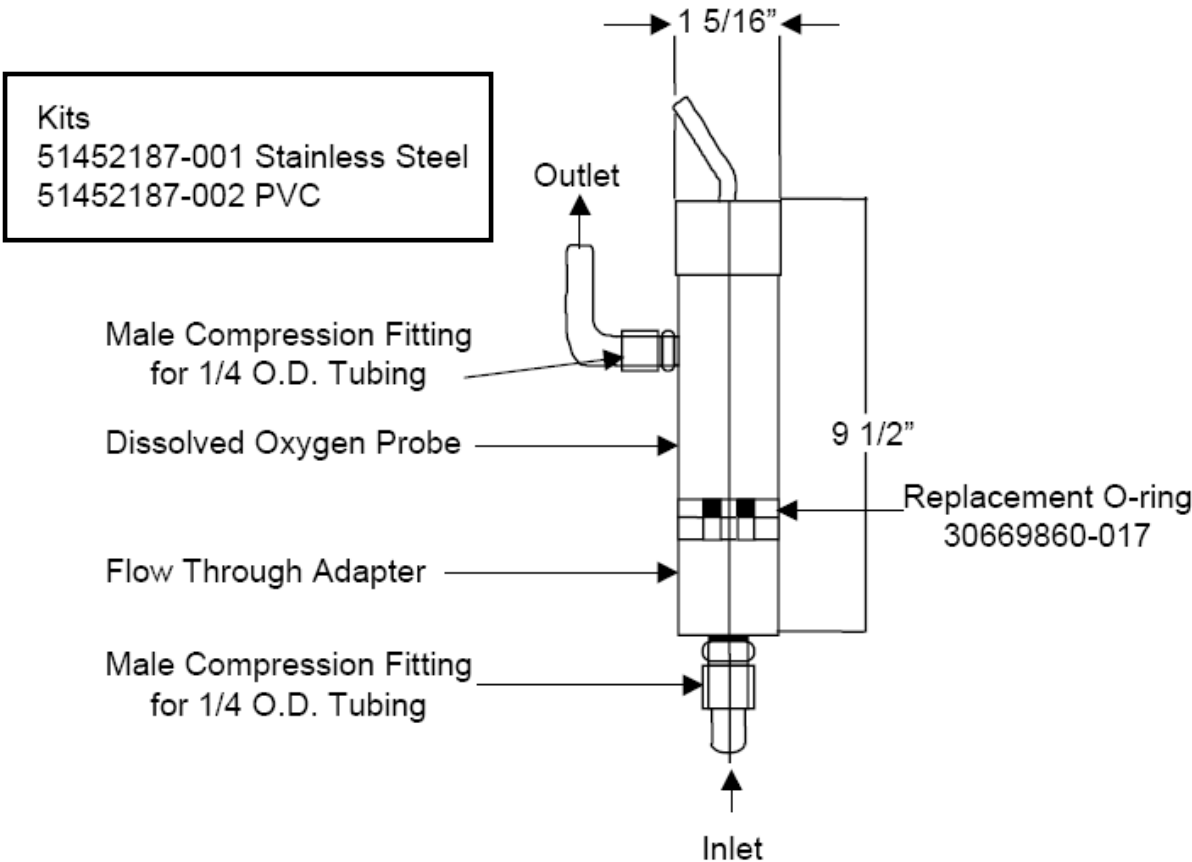


Medium fließt durch ein bauseitiges T-Stück (Inline)

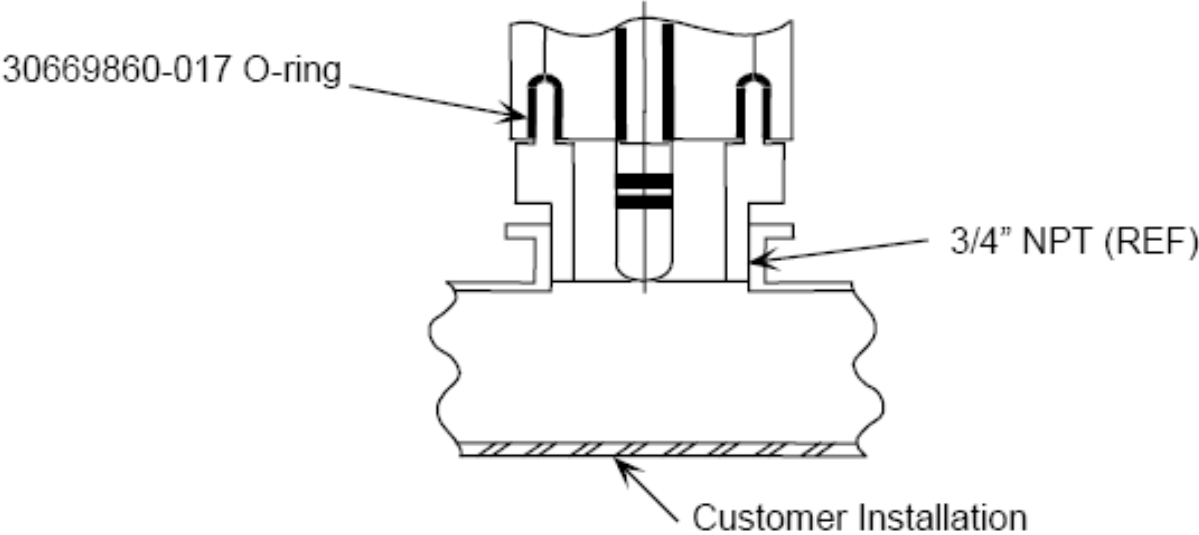

Kit #
51452226-001 (SST)
51452226-002 (PVC)

Eintauchmontage – empfohlen bei verschmutztem Medien

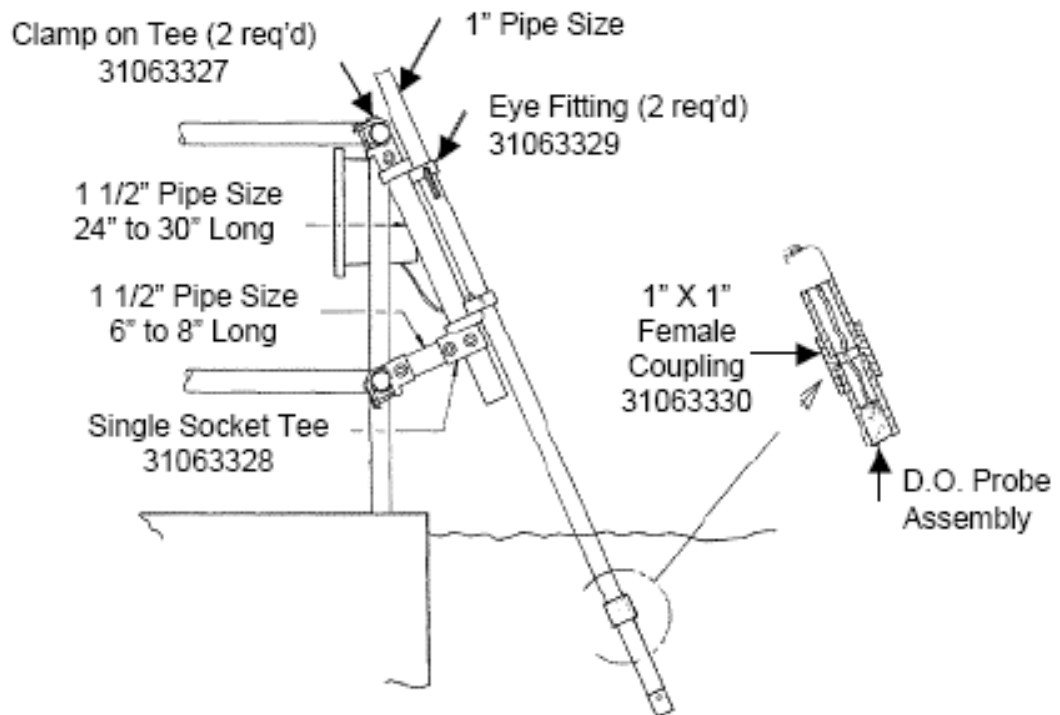

Bemerkung: Sonde hat am Kopfende ein 1" NPT Außengewinde zur Montage an einer bauseitigen Lanze (Kunststoff- oder Edelstahlrohr)

DL5000-Sonde in Edelstahlausführung Darstellung ohne Sensorschutzkorb und ohne Anschlußkabel

